Precision®

'Ready To Use Reagents'

version 2011.01

Certificate of Performance

Silica 3

Product Code **KR116**

Lot Number **1179**

Date 19.07.2011 **Expiry Date** 11.03.2012

Reagent	Lot Number
Silica 1	1177
Silica 2	1178
Silica 3	**1179**
Test Method	LTP04
Test Instrument	Konelab 20
Serial Number	P4919028

Standard Value	Lot #	Abs.
0.00	Silica-200 07 11	0.002
5.00	Silica-200 07 11	0.381
10.00	Silica-200 07 11	0.750
15.39	Silica-200 07 11	1.173
20.00	Silica-200 07 11	1.510

*serial dilution

Calibration Curve

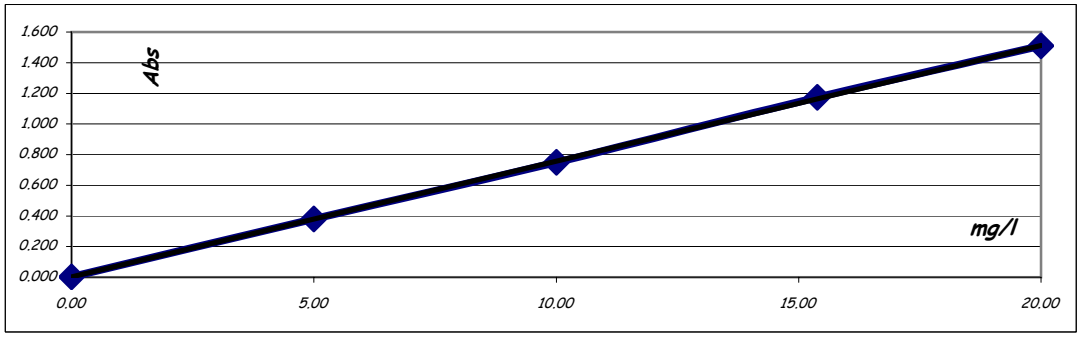

Test	Result	Specification			Pass / Fail
Intercept	0.001	-0.010	to	0.015	**Pass**
Sensitivity Abs/ppm	0.756	0.600	to	0.900	**Pass**
Regression	1.000	0.990	to	1.001	**Pass**

Notes *Store between 2 & 8 °c*
**Stable on Board 5 days*
Barcode ID = 114
** Based on results obtained in our Research Facility*

Tom Russell.

Dr. T. Russell

Serosep laboratory diagnostics

An ISO 9001:2008 Registered Company

Annacotty Business Park, Annacotty, Co. Limerick, Ireland

Telephone 061 358190 Facsimile 061 358191